


POROMETRE ÖLÇÜM BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Porometre ölçüm başlığındaki ışık sensörü unfiltered GaAsP photodiode olmalıdır.
2. Porometre ölçüm başlığındaki sıcaklık sensörü yüksek duyarlılığı olan 100K termistör olmalıdır.
3. Porometre ölçüm başlığının sıcaklık sensörünün ölçüm doğruluğu aşağıdaki gibi olmalıdır;
25 °C de; $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
0 ve 50 °C de; $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
4. Porometre ölçüm başlığındaki bağıl nemlilik sensörü vaisala 16663 HM olmalıdır.
5. Porometre ölçüm başlığı cup aperture ı boyutu 2.5 x 17.5 mm , çapı 6 mm olmalıdır.
6. Porometre ölçüm başlığının kablo uzunluğu 1,2 m olmalıdır.
7. Porometre ölçüm başlığının boyutu 110 x 30 x 27mm olmalıdır.
8. Porometre ölçüm başlığının ağırlığı kablo ile birlikte 130 g ı geçmemelidir.
9. Porometre ölçüm başlığı Delta-T Devices marka AP4 porometreye uyumlu olmalıdır.
10. Teklif veren ithalatçı firmanın üretici firmadan alınmış Tek yetkili belgesi olmalı ve teklifine eklemelidir.
11. Teklif veren ithalatçı firma porometre ölçüm başlığının kurulum ve eğitimini ücretsiz vermelidir.
12. Cihaz garanti kapsamında 1 yıl garantilidir.

Dr. Öğr. Üyesi Semsattin KULPAÇ

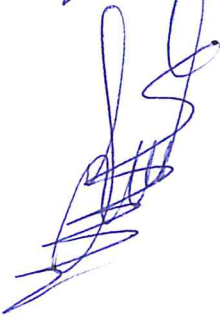

Doc. Dr. Ali Kemal ÖZBAKIRAN

